


Manometro tablero PH 141

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**TCK202010012**



Inspecciones y Servicios

RESPALDO TECNOLÓGICO EFICIENTE

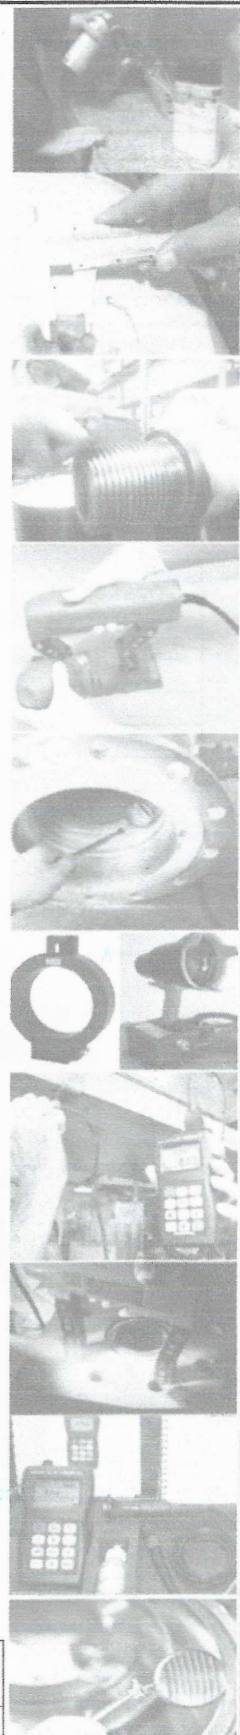

|          |             |                  |                    |                    |          |             |
|----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|
| 000      | 09/10/2020  | BASE TRIAL CHECK | GREEN OIL SERVICES | CERTIFICACIÓN Y PH | M.LOZANO | J.CASABARES |
| Revisión | Fecha Insp. | Lugar            | Cliente            | Detalle            | Revisó   | Aprobó      |



**MANÓMETRO**  
**BOURDON 4"**  
**0-160 Bar**  
**GOS201002**



**Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1**  
**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1**

Page  
Seite 1 / 2

Customer:  
Kunde: **TRIALCHECK**  
**12 de Septiembre 1535**  
**Neuquen Capital - 8300**  
**Neuquen - Argentina**

Certificate No.  
Zeugnis-Nr. **04285102**

Date  
Datum **10.11.2019**

Customer Order No.  
Kundenbestellnummer **PO00005360**

Customer Part. No.  
Kunden Artikel-Nr. **59854042**

Order Date  
Bestelldatum **10.11.2019**

Order No. / Item  
Auftrags-Nr. / Pos. **23000690/3**

Part No.  
Artikel-Nr. **59854042**

Model  
Typ **CPG1500**

Scale range  
Anzeigebereich **0 ... 1000 bar g**

Serial number  
Seriennummer **1A00VPW0F36**

Class  
Klasse **0,05 % FS**

Tag No.  
Messstellen-Nr.


Reference  
Referenzgerät  
**CPC8000-H 0,01 % FS 0 ... 1000 bar g**

Calibration No.  
Kalibriernummer  
**03474039**

Result  
Ergebnis

Temperature  
Temperatur **21°C +/- 1 K**

| Standard<br>Referenz<br>bar | Test Item<br>Prüfung<br>bar |        | rel. Deviation<br>rel. Abweichung<br>% |        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                             | ↑                           | ↓      | ↑                                      | ↓      |
| 0,000                       | 0,12                        | 0,11   | 0,012                                  | 0,011  |
| 125,000                     | 125,05                      | 125,11 | 0,005                                  | 0,011  |
| 250,000                     | 250,10                      | 250,10 | 0,010                                  | 0,010  |
| 375,000                     | 375,10                      | 375,12 | 0,010                                  | 0,012  |
| 500,000                     | 500,09                      | 500,07 | 0,009                                  | 0,007  |
| 625,000                     | 625,02                      | 625,03 | 0,002                                  | 0,003  |
| 750,000                     | 749,95                      | 750,01 | -0,005                                 | 0,001  |
| 875,000                     | 874,89                      | 874,90 | -0,011                                 | -0,010 |
| 1000,000                    | 999,85                      | 999,93 | -0,015                                 | -0,007 |

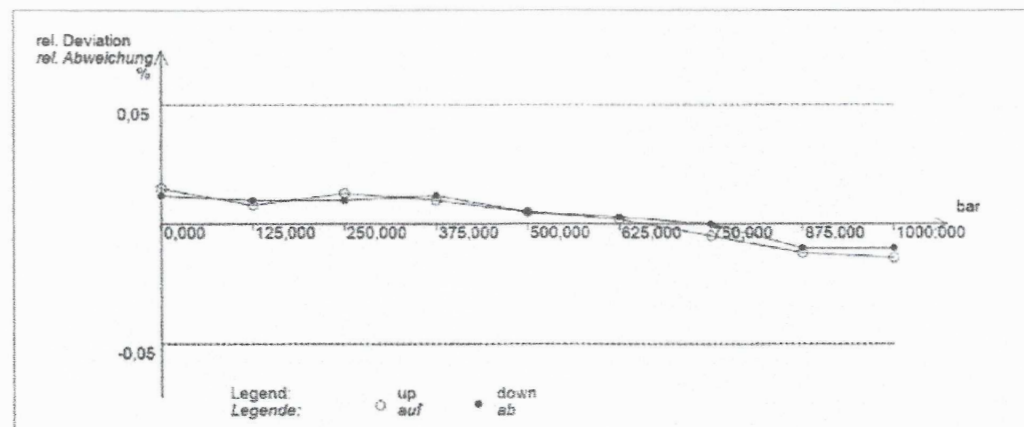



Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1  
**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1**

Customer: **TRIALCHECK**  
Kunde: **12 de Septiembre 1535**  
**Neuquen Capital - 8300**  
**Neuquen - Argentina**

Page  
Seite 2 / 2

Certificate No.  
Zeugnis-Nr. 04295102

Date  
Datum 10.11.2019

Object keeps the specification.

Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein.

Calibration was carried out according to the following norm:

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:

IEC 61298

Remarks / Bemerkung:

Inspection Representative  
Abnahmebeauftragter

(PI-CT)   
Harald Hartl

Examiner  
Prüfer

Kevin Wiesmann

This document was created automatically and needs no signature.  
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift.