

TAG. PH 141

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TRIAL CHECK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANGUERA R2AT 1"

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 1110 - ASME B31.4

NORMA DE APLICACIÓN
ASME E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA

N° CERTIFICADO
WIKI 04285102

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
10/11/19 - 10/11/2020

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA R2AT 1" X 15 MTS	TCK 00077 - GOS2010.01	IV-PH 1,5Kpsi - 10/20	1500 psi 105Kg/cm ²	No se obs. Perdida o fuga de fluido, ni caída de presión. No se obs. Indicaciones relevantes.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
05/10/2020

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTOLO

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
05/10/2020

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN:

MANG. PH 141

DATOS GENERALES

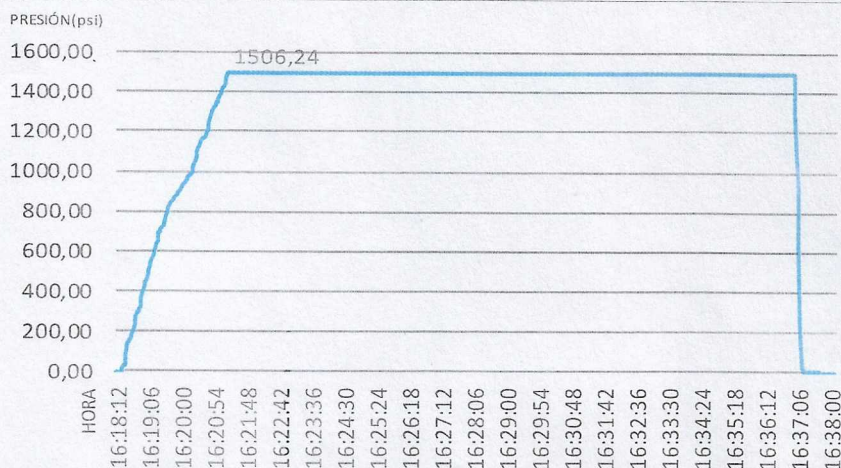
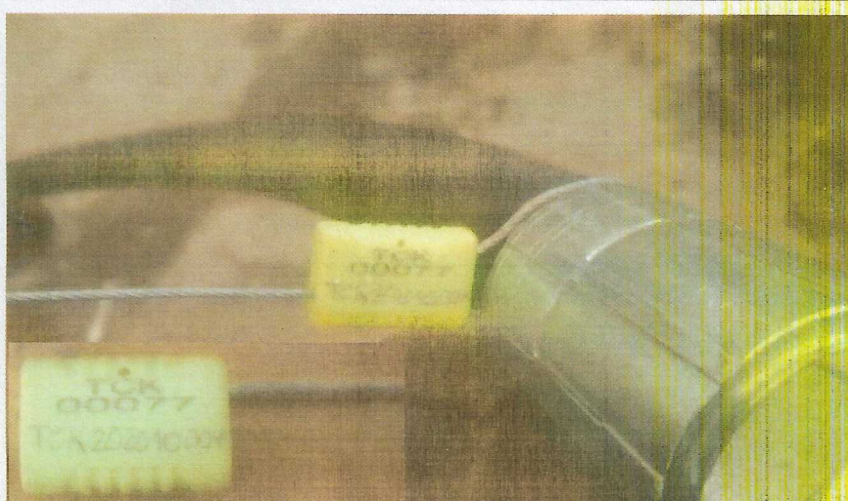
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TRIAL CHECK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA R2AT 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 1110 - ASME B31.4	NORMA DE APLICACIÓN ASTM E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO WIKA 04285102	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 10/11/19 - 10/11/2020
--	-------------------------------------	--	---

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA R2AT 1" X 15 MTS TCK 00077 - GOS2010.01	IV-PH 1,5Kpsi - 10/20 1500 psi 105Kg/cm2	No se obs. Perdida o fuga de fluido, ni caída de presión. No se obs. Indicaciones relevantes.	APTO

REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

Se realiza prueba hidráulica del manguetore y prensado con agua a temperatura ambiente(20,7°C) en un tiempo aproximado 10-15min ,llegando a una presión de 1506 PSI. No se observa fugas o perdidas de fluidos. **RESULTADO SATISFACTORIO**

Precinto

TCK202010004

TCK 00077

IV-PH 1,5Kpsi - 10/20

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
05/10/2020

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
05/10/2020

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN: