

DATOS DEL CILINDRO

Cliente: GREEN OIL SERVICES	
Marca: LUXFER MSA	N.º de Serie : OJ-386278
Fecha PH: 11/20	PT del Cilindro: 2216 PSI
	Fecha de Recarga: 17/02/22

DATOS DE LA CARGA DEL CILINDRO


Fecha de Análisis: DICIEMBRE 2021	
Técnico que genero la muestra de aire: OSCAR CORREA	
Propietario del compresor: WELL DONE SERVICES SRL	
Marca: AEROTÉCNICA COLTRI S.p.A.	Modelo: MCH6
Nº de Serie: 0438	Lugar de la toma de muestra: COMPRESOR

ESTANDAR DE LA CALIDAD DE AIRE RESPIRABLE

		Grado del Estándar ACCEPTABLE		
NORMAS	SUBSTANCIAS	GUIA	UNIDADES	RESULTADO
	Oxigeno (O2)	20-22	%	20,9
	Monóxido de Carbono (CO)	5	ppm	0
	Dióxido de Carbono (CO2)	500	ppm	30
	Nieblas de Aceite	1.0	mg/m3	0
	Nieblas de Agua	27	ml/m3	18
	Olor	Ninguno		NINGUNO

OBSERVACIONES: El presente Protocolo asegura la calidad de aire con el que fue recargado el Cilindro. El uso y mantenimiento del mismo, es responsabilidad de su poseedor, quedando excluido del presente protocolo su certificación.

RESULTADO: APTO



Tecnico Oscar Correa
Well Done Services S.R.L

Certificación de Calidad de Aire Respirable

Dräger

Cliente	Well Done Services SRL	Fecha Expedición del Certificado	15/12/2021 15:02
Número de cliente	VC.000.842		
Número de orden	SR.###.###		

Datos del Cilindro a Evaluar							
Propietario: Well Done Services SRL	Marca: MSA	Serial: DG459512	Fecha P.H: oct-17				
Presión de trabajo: 2216psi	Volumen: 6 lts	Fecha de carga: 10/12/2021	Valido para prueba	☒			
Datos del Compresor de Carga							
Propietario: Well Done Services SRL	Marca: Coltri	Modelo: MCH6	Serial: 438				
Instrumento de Análisis de Calidad de Aire Respirable							
Equipo de análisis	☒	Multitest med. Int	Referencia	6527321	Serial	AREC-9023	
	☐	Aerotest Simulatn HP	Referencia	6525951	Serial		
Análisis a ser Realizado en							
Compresor	☒	Equipo de protección respiratoria	☐	Equipo de buceo ocupacional	☐		
Pureza de Gases del Área Hospitalaria				☐			
Elementos de Prueba Multitest Med							
Tipo de prueba	Ref. Inst. de prueba	Serial	Fecha de Expiración	Tiempo de Prueba	Umbral de aceptación	Valor Obtenido	Aprueba
Tubo colorimétrico aceite	6728371	ARPC-1981	nov-23	5 min	≤ 0,1 mg/m3	0 ppm	☒
Dioxido de Carbono	6728521	ARPD-2341	sep-23	5 min	≤ 500 ppm	30 ppm	☒
Dioxido de Azufre				5 min	≤ 1 ppm	N/A ppm	☐
Sulfuro de Hidrógeno	8101831	NC-2561	dic-22	6 min	≤ 1 ppm	0 ppm	☒
Gases Nitrosos	8103661			2.5 min	≤ 2 ppm	N/A ppm	☐
Monoxido de Carbono	6728511	ARPC-1691	sep-23	5 min	≤ 5 ppm	0 ppm	☒
Vapor de Agua	8103061	MK-1781	ene-22	10 min	≤ 60 ppm (45mg/m3)	18 mg/m3	☒
Elementos de Prueba Aerotest Simulatn HP							
Tipo de prueba	Ref. Inst. de prueba	Serial	Fecha de Expiración	Tiempo de Prueba	Umbral de aceptación	Valor Obtenido	Aprueba
Aceite Impactor	8103560			5 min	≤ 0,5 mg/m3	ppm	☐
Tubo colorimétrico aceite	8103111						
Dioxido de Carbono	6728521			5 min	≤ 500 ppm	ppm	☐
Monoxido de Carbono	6728511			5 min	≤ 5 ppm	ppm	☐
Vapor Agua (≤200 Bar)	8103061			10 min	≤ 50 mg/m3	mg/m3	☐
Vapor Agua (>200 Bar)					≤ 35 mg/m3		
Olor	--	--	--	--	Sin olor	--	☐
Oxígeno	Dräger ☐ c	ARKE-2122	11/5/2022	2 min	21%Vol (± 1 %)	20.90%	%Vol
	Dräger ☒ X-am						

Dräger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este 1717
 (B1607BLF) San Isidro
 Buenos Aires - Argentina

Tel +54 11 4836 8310 / Fax +54 11 4836 8321
 Info-argentina@draeger.com / www.draeger.com.ar

F.CA_ZJ00 2

1/2

Normas que regulan el presente certificado


- ☐ Farmacopea Europea 2.1.6 Suplemento 2000 - Pureza de gases médicos.
- ☐ AS 1715-1994 - Equipos de protección respiratoria.
- ☐ AS 2299-1992 - Buceo ocupacional.
- ☐ CAN/CSA-Z180.1-00 - Sistemas de Aire Respirable Comprimido.
- ☐ BS EN12021 & EN12021:2014 - Equipos de protección respiratoria y aire comprimido para aparatos respiratorios.
- ☐ CGA G-7.1 - 1989/OSHA estandar 29 CFR 1910.134(i)(1) - Grado D para aire respirable.

El procedimiento Dräger para el análisis de aire respirable cumple con las más estrictas normativas estandarizadas, en donde se asegura la calidad del aire evaluado. El mantenimiento y uso del equipamiento analizado se excluye del presente protocolo.

Comentarios adicionales:

Responsable Técnico

Firma

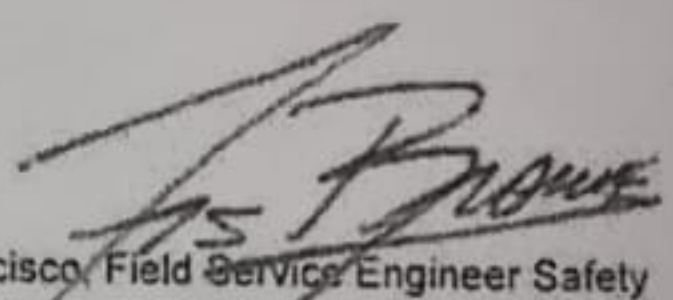
Browne Francisco, Field Service Engineer Safety

Certificado valido hasta el dia 15/12/2022

F.CA_ZJ00.2