



WELL DONE SERVICES S.R.L.

WELL DONE SERVICES SRL

LABORATORIO DE CALIBRACION

Fecha de Calibración:

18/02/2022

Número de Certificado de Calibración: 6990

Empresa : WELL DONE SERVICES S.R.L

Equipo: APTO PARA SU USO.

Instrumento: HONEYWELL XCD H2S

SN: K0353919111904

Gas Patrón	Objetivo a Verificar	Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones			Incertidumbre de la medición	Esp.de Tol(*)
				1	2	3		
Ácido Sulfhídrico (H2S) 25 ppm	25 ppm	10%	KBJ- X02AI99CP586206- 2	25	25	25	2,0817	

Observaciones :

Calibración: *Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST*

Condiciones ambientales de Calibración:

Temperatura (°C)

22°C

Presión atmosférica (hPa):

1008hPa

Humedad (%):

39 %

WELL DONE SERVICES SRL.

Gdor.Elordi 2135- Neuquen

Provincia de Neuquén

TEL/fax (+54299) 4049301


E-Mail : info@welldonesrl.com.ar

Web site: <http://www.welldonesrl.com.ar>

Los resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo exclusivos a cualquier otro
La reproducción de este documento sólo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

Cantidad de hojas: 1
COD 200808v004

OSCAR CORREA
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Well Done Services S.R.L

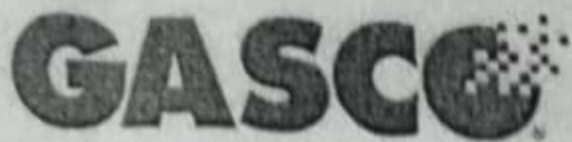

GASCO AFFILIATES, LLC.

320 Scarlet Blvd.
Oldsmar, FL 34677
(800) 910-0051
Fax: (866) 755-8920
www.gascogas.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: April 22, 2020

Customer: Dastec SRL USA LLC

Order Number: D 0001-20200174

Lot Number: KBJ-X02AI99CP586206-2

Use Before: 04/22/2022

Component	Specification (+/- 5%)	Analytical Result (+/- 2%)
Hydrogen Sulfide	25 PPM	26 PPM
Air	Balance	Balance

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8" -18UNF
Pressure: 500 psig

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:

Dan Rojas
Dan Rojas