

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.
Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.
El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

1- Información de calibración.

Objeto: Termómetro Nuova Fima 0 °C a 250 °C
Fecha de calibración del instrumento: 10/02/2023
N° de Serie / Identificación: H-21
Fecha de emisión del certificado: 13/02/2023

Resultados:	Referencias:
Acceptado: SI	As-Found / As-Left: Como recibido / Como entregado
Estado Found/Left: Found-Left	Found-Left: Entregado como recibido
Estado del sello ajuste: OK	TUR: Relación de incertidumbre de la prueba.
	FDT: Fuera de tolerancia

2- Datos de la calibración.

Datos del cliente	Datos del Laboratorio
-------------------	-----------------------

Cliente: Green Oil Services SA	Calibrado por: Giuliana Valenti Cristallini
C.U.I.T. 30-70858254-5	Domicilio: Alderete 2393 - Neuquén
Domicilio: Av. Conquistadores del Desierto 2450 - Neuquén Capital	Temperatura y humedad ambiente al 26,1 °C ± 0,5°C
	momento de la calibración: 33,2 % ± 0,3%

Número de páginas del certificado y anexos: 5

3 - Procedimientos aplicados

Eléctricos: NA
Presión: NA
Temperatura: PCTT-01
Dimensional: NA
Gases: NA
Mecánico NA
SH: NA

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.


CCTT-0040223 - 1

Temperatura	0	250	1	5
-------------	---	-----	---	---

5 - Resultados obtenidos.

Control de la escala de medición de temperatura 0 a 300 °C.

Temperatura indicada	1º Medición Ascen.	2º Medición Desc.	Promedio	Desvío	Error en el punto	Incertidumbre	Máximo desvío permitido	Cumple espec. del fabricante
250	247.6	247.6	247.6000	2.4000	0.9600	± 1.4453	± 2.5	SI
200	197.8	197.7	197.7500	2.2500	1.1250	± 1.447	± 2.5	SI
150	148.0	148.1	148.0500	1.9500	1.3000	± 1.447	± 2.5	SI
100	99.1	99.0	99.0500	0.9500	1.2517	± 1.447	± 2.5	SI
50	50.5	50.5	50.5000	0.5000	1.0000	± 1.4453	± 2.5	SI
°C	°C	°C	°C	°C	%	°C	°C	-

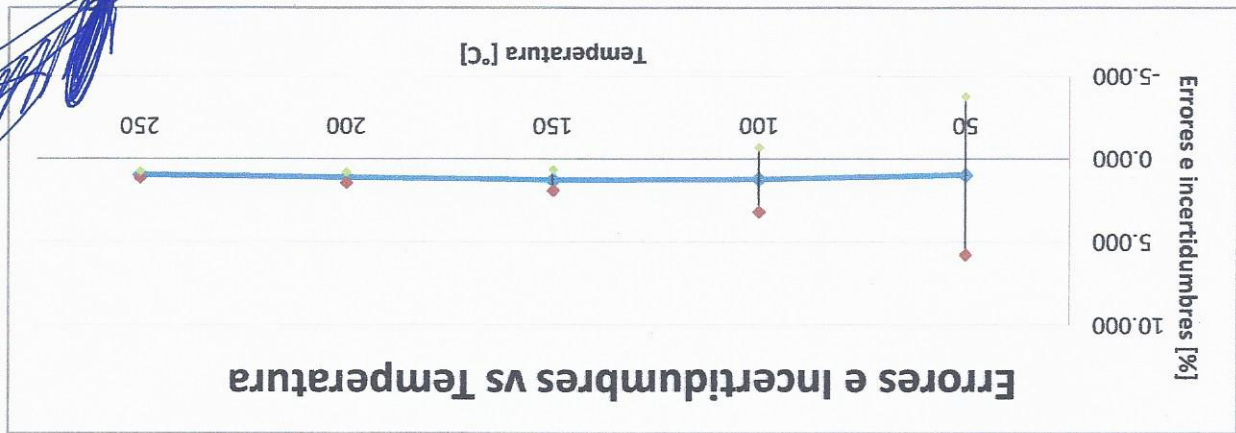

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.