

Certificado de calibración N°: CCPT-0201222

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones I.N.T.I. / N.I.S.T. / UKAS, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

1- Información de calibración.

Objeto: Manómetro Wika 232

Fecha de calibración del instrumento: 16/12/2022

N° de Serie / Identificación: NA

Fecha de emisión del certificado: 17/12/2022

Resultados:	Referencias:
Aceptado: SI Estado Found/Left: Found-Left Estado del sello ajuste: OK	As-Found / As-Left: Como recibido / Como entregado Found-Left: Entregado como recibido TUR: Relación de Incertidumbre de la prueba. FDT: Fuera de tolerancia

2- Datos de la calibración.

Datos del cliente	Datos del Laboratorio
Cliente: Green Oil Services SA C.U.I.T. 30-70858254-5 Domicilio: Av. Conquistadores del Desierto 2450 - Neuquén	Calibrado por: Giuliana Valenti Cristallini Domicilio: Alderete 2393 - Neuquén Temperatura y humedad ambiente al momento de la calibración: 24,8 °C ± 0,5 °C 36,7 % ± 0,6 %

Número de páginas del certificado y anexos: 10

3 - Procedimientos aplicados

Eléctricos: NA

Presión: PCPT-01

Temperatura: NA

Dimensional: NA

Gases: NA

Mecánico NA

SH: NA

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

4 - Características del instrumento.


Escala	Rango		Clase F.S.	Resolución
	LRV	URV		
	Kg/cm ²	Kg/cm ²		
Presión	0	100	1	2

5 - Resultados obtenidos.


Control de la escala de medición de presión

Presión Indicada	1ª Medición Ascen.	2ª Medición Desc.	Promedio	Desvió	Error en el punto	Incertidumbre	Máximo desvío permitido	Cumple espec. del fabricante
Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	%	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-
20	20.14	20.10	20.120	0.120	0.6000	± 0.5629	± 1	SI
40	40.18	40.15	40.165	0.165	0.4125	± 0.5787	± 1	SI
60	59.99	60.17	60.080	0.080	0.1333	± 0.592	± 1	SI
80	80.04	79.95	79.995	0.005	0.0062	± 0.5816	± 1	SI
100	99.93	99.86	99.895	0.105	0.1050	± 0.5803	± 1	SI

Desvíos e Incertidumbres vs Presión

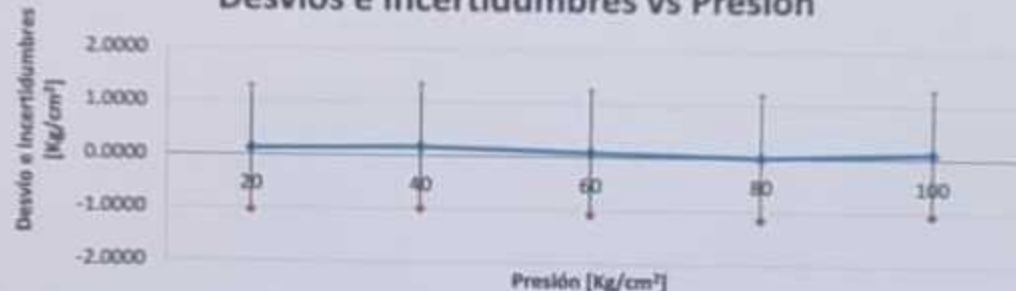

Errores e Incertidumbres vs Presión

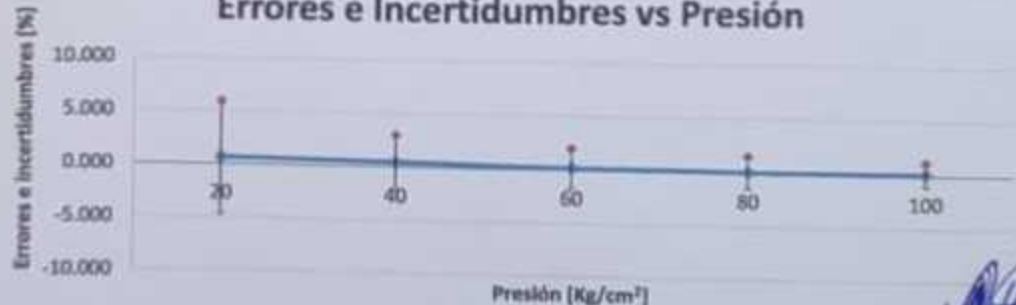

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Tecnoplus de Ing Aldo A. Bruschi

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar

web: tecnoplusonline.com.ar

REV: 5/19

Maestro Alderete 2393,

Neuquén capital,

Prov. de Neuquén.

Tel: 0299-4478540

6 - Patrones utilizados.

Instrumento	Identificación	Certificado	Emitido por:	Fecha de vencimiento
Fluke 750P09	CCP-003-21	CCPT-0341122	Aldo A. Bruschi	30/11/2023
Fluke 754	CCP-009-17	CCET-0251122	Aldo A. Bruschi	30/11/2023
Testo 410-2	CCP-015-20	CCSHT-0041022	Aldo A. Bruschi	14/10/2023

 GIULIANA VALENTI Técnico Electrónica	 GUILLERMO C. POMPEI Técnico Electrónica Mat. TEC 4060
Calibrado por: Giuliana Valenti C. Técnica de Laboratorio	Aprobado por: Guillermo C. Pompei, Supervisor de Laboratorio

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.