

Laboratorio Tecnoplus S.A.S.

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar

web: www.tecnoplusonline.com.ar

Rev. 1/24

Maestro Alderete 2393.

Neuquén capital.

Prov. de Neuquén.

Tel: 0299-4478540

Certificado de calibración N°: CCTT-0020125

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones I.N.T.I. / N.I.S.T / UKAS, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI), acuerdo a la norma ISO 17025.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Laboratorio Tecnoplus SAS.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no tendrán validez.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

1- Información de calibración.

Objeto: Termómetro CENI

Fecha de calibración del instrumento: 08/01/2025

N° de Serie / Identificación: --/--

Fecha de emisión del certificado: 09/01/2025

Resultados:	Referencias:
Acceptado: SI	As-Found / As-Left: Como recibido / Como entregado
Estado Found/Left: Found-Left	Found-Left: Entregado como recibido
Estado del sello ajuste: OK	TUR: Relación de incertidumbre de la prueba.

2- Datos de la calibración.

Datos del cliente	Datos del Laboratorio
Cliente: Green Oil Service SA	Calibrado por: Bianca Ailín Navarrete
C.U.I.T. 30-70858254-5	Domicilio: Alderete 2393 - Neuquén
Domicilio: Av. Conquistadores del Desierto 2450, PIN Oeste - Neuquén capital.	Temperatura y humedad ambiente 28,0 °C ± 0.5°C al momento de la calibración: 33,9 % ± 0.3%


Número de páginas del certificado y anexos: 4

Procedimientos: PCTT-06

3 - Patrones utilizados.

Instrumento	Identificación	Certificado	Emitido por:	Fecha de vencimiento
Fluke 5615	PLT-038-24	1006051	Akrimet	16/02/2025
Fluke 712	PLT-038-24	7967093	Akrimet	16/02/2025
Testo 0636 9770	PLT-053-24	2024-006533-1	Testo	21/05/2025


Guillermo C. Pompei. Supervisor de laboratorio

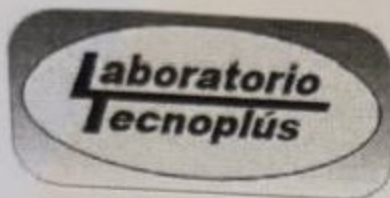

Laboratorio Tecnoplus S.A.S.

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar

web: www.tecnoplusonline.com.ar

Rev. 1/24

Maestro Alderete 2393.

Neuquén capital.

Prov. de Neuquén.

Tel: 0299-4478540



4 - Características del instrumento.

Escala	Rango		Clase F.S.	Resolución
	LRV	URV		
	°C	°C		
Temperatura	0	120	2	2

5 - Resultados obtenidos.

Control de la escala de medición de temperatura 0 a 120 °C.

Temperatura indicada	1° Medición Ascen.	2° Medición Desc.	Promedio	Desvío	Error en el punto	Incertidumbre	Máximo desvío permitido	Cumple espec. del fabricante
°C	°C	°C	°C	°C	%	°C	°C	-
20	22,3	22,3	22,30000	2,30000	11,5000	± 0,5785	± 2,4	SI
40	42,2	42,2	42,20000	2,20000	5,5000	± 0,5785	± 2,4	SI
60	62,2	62,2	62,20000	2,20000	3,6667	± 0,5785	± 2,4	SI
80	81,9	81,9	81,90000	1,90000	2,3750	± 0,5785	± 2,4	SI
100	101,7	101,7	101,70000	1,70000	1,7000	± 0,5785	± 2,4	SI
120	120,8	120,8	120,80000	0,80000	0,6667	± 0,5785	± 2,4	SI

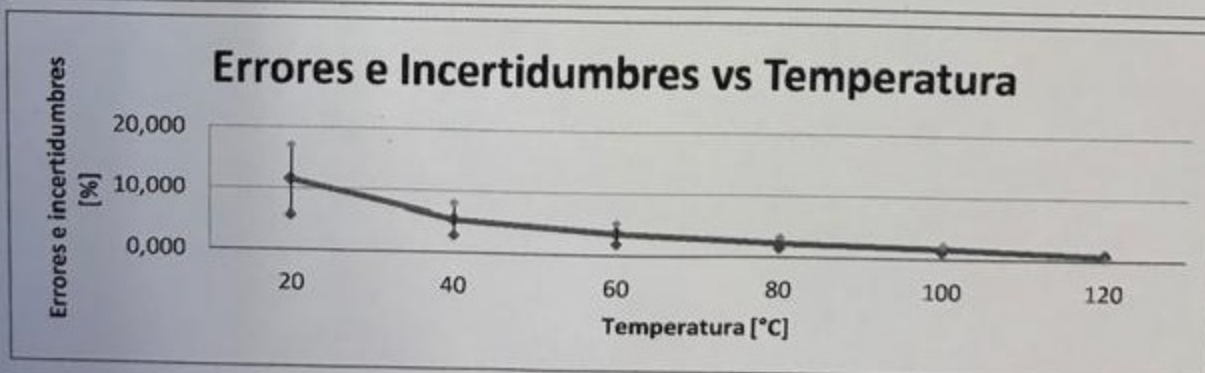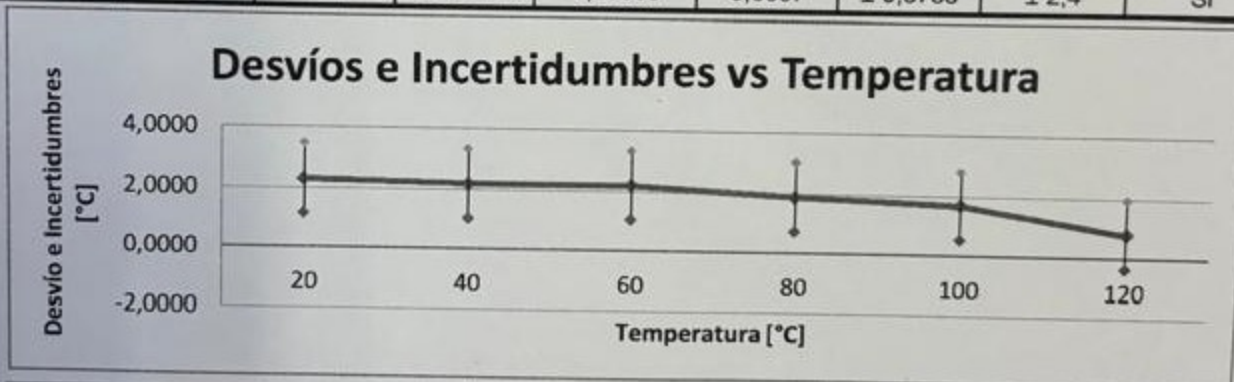

NAVARRETE BIANCA
Técnico Electrónico

Calibrado por:

Bianca A. Navarrete. Técnica de laboratorio

GUILLERMO C. POMPEI
Técnico Electrónico
MST TEC 4050

Aprobado por:

Guillermo C. Pompei. Supervisor de laboratorio.

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto	Termómetro Digital
Fabricante	Fluke
Modelo	712
Número de serie	7967093/1006051
Identificación interna	Sin informar
Intervalo de medición	STE -30 a 150°C
Menor división	0,1°C
Número de solicitud	1805
Determinaciones requeridas	Calibración
Fecha de calibración o medición	16/02/2024
Fecha de emisión del Certificado	04/06/2024
Nombre del cliente	Laboratorio Tecnoplus S. A. S.
Domicilio del cliente	Alderete 2393, Neuquén, Buenos aires, Argentina.
Lugar de calibración	Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.