


**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202506020**




000	17/06/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

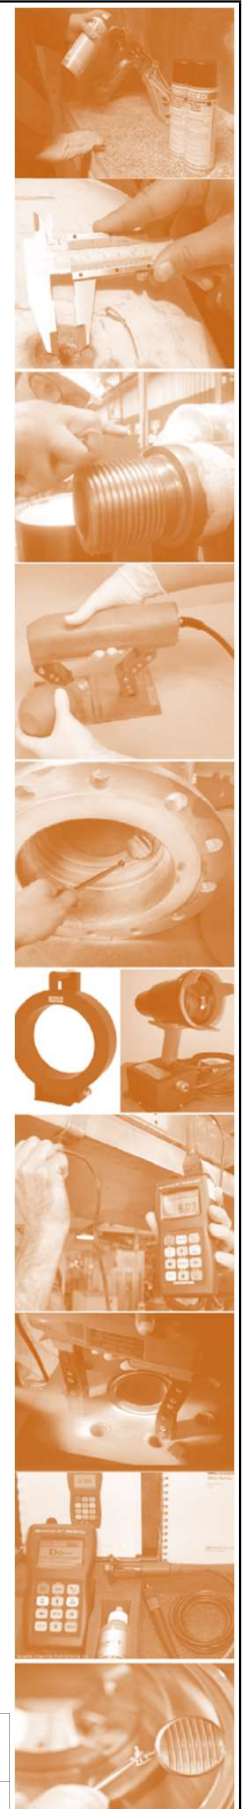

VÁLVULA SEGURIDAD 1"




		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (RESUMEN) 1		CERTIFICADO: TCK202506020			
				Fecha Insp: 17/06/2025 Nueva Inspec.: 17/06/2026			
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"			
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 10,2°C / Humed 52%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096283 - GOS240901	IV-CAL 70 kg/cm2-F INSP 06/25	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 17/06/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:				CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 17/06/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
Pag. 2 de 3							

CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 10,2°C / Humed 54%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096283 - GOS240901	IV-CAL 70 kg/cm2-F INSP 06/25	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

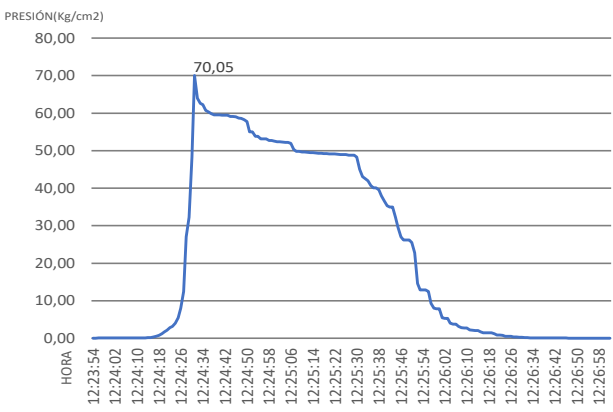

Presión(Kg/cm2)

HORA

12:23:54
12:24:02
12:24:10
12:24:18
12:24:26
12:24:34
12:24:42
12:24:50
12:24:58
12:25:06
12:25:14
12:25:22
12:25:30
12:25:38
12:25:46
12:25:54
12:26:02
12:26:10
12:26:18
12:26:26
12:26:34
12:26:42
12:26:50
12:26:58

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

70,05

OBSERVACIÓN:
Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrandose pico de 70,05 kg/cm2 máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 10,2 °C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202506020 0096283 - IV-CAL 70 kg/cm2-F INSP 06/25

OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 17/06/2025 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 17/06/2025 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: