

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202601027 A



**TRIAL ^{OF}
CHECK**

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	16/01/2026	BASE TEX NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIBRACIÓN	M LOZANO	D VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANÓMETRO
BOURDON 4"



QUEDA TERMINantemente PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVA AUTORIZACIÓN ESCRITA



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: ZCR202601/27

Fecha Imp: 16/01/2026

Nueva Impres: 16/01/2027

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO N°
TOK-PSI-M-001

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TOR

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANÓMETRO ROULE/SN 4

NORMA DE APLICACIÓN
ASME B40.100

CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 27 °C Humid 37%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRECION DE CALIBRACION / PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Manómetro Bourdon 4"	GDS260903	IV-CAL 0-1400 psi - F INSP 0126	0-100 bar / 1400 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su uso.	PASO
2	4	Manómetro Bourdon 4"	GDS260106	IV-CAL 0-3000 psi - F INSP 0126	0-200 bar / 3000 psi	Mediciones aceptables. El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su uso.	PASO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
16/01/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico LEO D. Valles
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTRÓLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
16/01/2026

Control de Calidad y Coordinaciones
Ing. M. J. J. J.
FIRMA / ACLARACIÓN:



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO

CERTIFICADO: TCA202601027
N° SERIE: G09256993
Fecha Val: 16/01/2026
Nueva Inspección: 16/01/2027

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO CALIBRACIÓN
TCK-PCGM-001

DATOS GENERALES
LUGAR
RASE, TOR
NORMA DE APLICACIÓN
ASME B40.100

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANÓMETRO REGISTRADOR
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura: 22 °C / Humedad: 21%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANÓMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CEN/NOUWRA

CLASE
K0.05

N° CERTIFICADO
NAC-GRD0124014

CALÍVEN DEL INSTRUMENTO
2710000100000000

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR

Item	Instrumento	Marca	Modelo	N° Serie	Díámetro	Clase	Rango	Graduación
1	Manómetro Bourdon 4"	CEN	Pos-Nou 3/4 1/2" NPT	G09256993	4" (100mm)	K0.05	0 a 1400 psi	0.25 psi


CONTROL DE LINEALIDAD (PSI)

Presión de Ref. (bar)	Presión de Ref. (psi)	Medición 1 (psi)	Medición 2 (psi)	Medición 3 (psi)	Medición 4 (psi)	Medición 5 (psi)	Graduación (psi)	Error (%)	Resultado
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE
13.79	200	210.00	200.00	220.00	210.00	10.00	10.00	0.71	ACEPTABLE
41.38	600	620.00	600.00	600.00	606.67	6.67	6.67	0.48	ACEPTABLE
55.17	800	810.00	800.00	800.00	803.33	3.33	3.33	0.24	ACEPTABLE
82.76	1200	1210.00	1200.00	1210.00	1206.67	6.67	6.67	0.48	ACEPTABLE
98.55	1400	1390.00	1390.00	1400.00	1393.33	-6.67	-6.67	-0.48	ACEPTABLE

La precisión de la medición corresponde a un factor de seguridad de 4:1 para un intervalo de confianza aproximado del 95%.

OBSERVACIÓN GENERAL: RESULTADO SATISFACTORIO. EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA APTO PARA SER UTILIZADO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

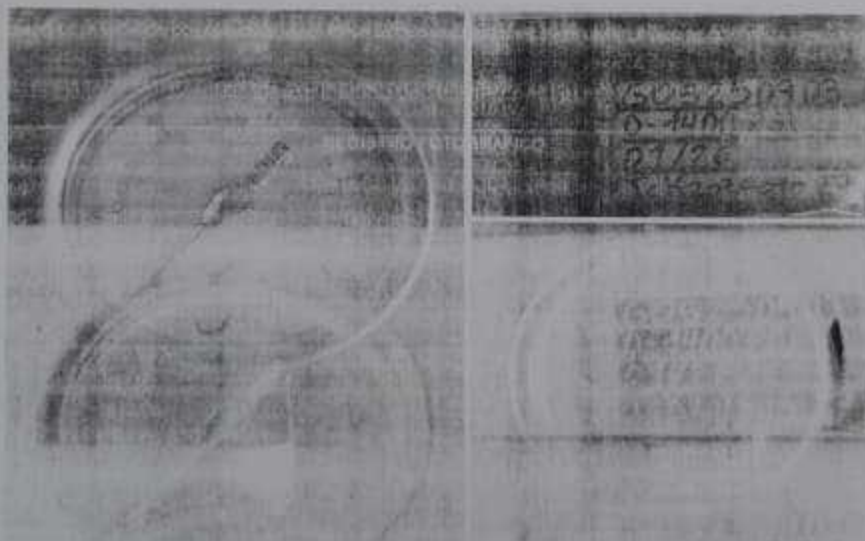

Trial of Check Control
a los patrones de la

OPERADOR

LUGAR
NEUQUÉN
FECHA
16/01/2026

LUGAR
NEUQUÉN
FECHA
16/01/2026

Operaciones

QUECE TERMINA

Pag. 3 de 4



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO

CERTIFICADO: TCKJ02501027
N° SERIE: 002250196
Fecha: 16/01/2026
Nuevo: 16/01/2027

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR

BASE TEK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

MANÓMETRO Bourdon

PROCEDIMIENTO CALIBRACIÓN
TCK-P004-001

NORMA DE APLICACIÓN

ASME B31.3

CONDICIONES AMBIENTALES

Temp: 21 °C Humid: 71%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANÓMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA / SELLO

CPO35504996A

PATRÓN UTILIZADO

CLASE

RS-75

N° CERTIFICADO

MDG-00017-2024

CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO

4300711-00030020

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR								
Item	Instrumento	Marca	Modelo	N° Serie	Diámetro	Clase	Rango	Graduación
2	Manómetro Bourdon	CPR	MDG-00017-2024	002250196	4" (101.6 mm)	RS-75	0 - 300 psig	150 psi


CONTROL DE LINEALIDAD (PS)

Presión de Ref. (bar)	Presión de Ref. (psi)	Ubicación 1	Ubicación 2	Ubicación 3	Ubicación 4	Ubicación 5	Ubicación 6	Ubicación 7	Ubicación 8	Resultado
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE
34.48	500	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	ACEPTABLE
68.97	1000	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	ACEPTABLE
103.45	1500	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	ACEPTABLE
137.93	2000	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	ACEPTABLE
206.90	3000	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	ACEPTABLE

LA VERIFICACIÓN DE LA LINEALIDAD SE REALIZA EN EL CENTRO DE CALIBRACIÓN DE LA EMPRESA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

OBSERVACIÓN GENERAL: RESULTADO SATISFACTORIO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN, SE APTO PARA SER UTILIZADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

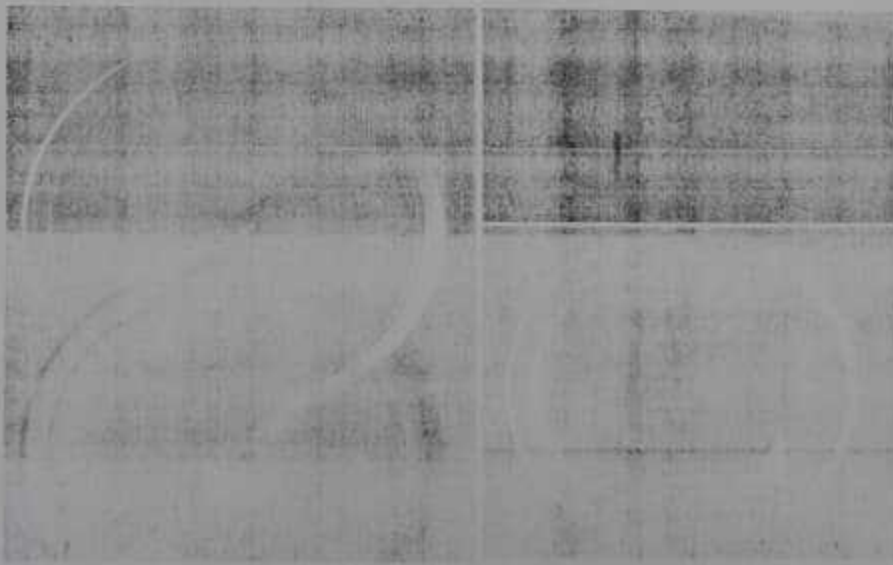

El Trial of Check Certificado de Calibración es un documento que certifica la exactitud de las mediciones realizadas por el equipo de calibración de la empresa CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

OPERADOR	CERTIFICADO
LUGAR NEUQUÉN FECHA 16/01/2026	LUGAR NEUQUÉN FECHA 16/01/2026