

Laboratorio Tecnoplus S.A.S.

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar

web: www.tecnoplusonline.com.ar

Rev. 1/24

Maestro Alderete 2393.

Neuquén capital.

Prov. de Neuquén.

Tel: 0299-4478540

Certificado de calibración N°: CCTT-0060925

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones I.N.T.I. / N.I.S.T / UKAS, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI), acuerdo a la norma ISO 17025.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Laboratorio Tecnoplus SAS.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no tendrán validez.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

1- Información de calibración.

Objeto: Termómetro CENI

Fecha de calibración del instrumento: 15/09/2025

N° de Serie / Identificación: 814

Fecha de emisión del certificado: 17/09/2025

Resultados:	Referencias:
Aceptado: SI	As-Found / As-Left: Como recibido / Como entregado
Estado Found/Left: Found-Left	Found-Left: Entregado como recibido
Estado del sello ajuste: OK	TUR: Relación de incertidumbre de la prueba.

2- Datos de la calibración.

Datos del cliente	Datos del Laboratorio
Cliente: Green Oil Service SA	Calibrado por: Bianca Ailin Navarrete
C.U.I.T. 30-70858254-5	Domicilio: Alderete 2393 - Neuquén
Domicilio: Av. Conquistadores del Desierto 2450, PIN Oeste - Neuquén capital.	Temperatura y humedad ambiente al momento de la calibración: 23,0 °C ± 0,5 °C 53,8 % ± 0,3 %


Número de páginas del certificado y anexos 5

Procedimientos: PCTT-06

3 - Patrones utilizados.

Instrumento	Identificación	Certificado	Emitido por:	Fecha de vencimiento
Fluke 5615	PLT-020-25	1006051	Sice	23/07/2026
Fluke 712	PLT-021-25	7967093	Viditec	10/07/2026
Testo 608-H1	PLT-011-25	2025-013795-1	Testo	05/05/2026


Guillermo C. Pompei, Supervisor de laboratorio

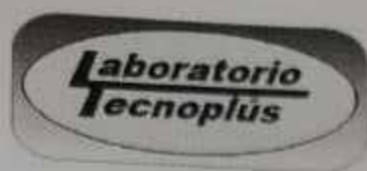

Laboratorio Tecnoplus S.A.S.

email: laboratorio@tecnoplusonline.com.ar

web: www.tecnoplusonline.com.ar

Rev. 1/24

Maestro Alderete 2303

Neuquén capital

Prov. de Neuquén

Tel: 0299-4478540

4 - Características del instrumento.


Escala	Rango		Clase F.S.	Resolución
	LRV	URV		
	°C	°C		
Temperatura	0	250	1	5

5 - Resultados obtenidos.


Control de la escala de medición de temperatura 0 a 250 °C.

Temperatura indicada	1° Medición Ascen.	2° Medición Desc.	Promedio	Desvío	Error en el punto	Incertidumbre	Máximo desvío permitido	Cumple espec. del fabricante
°C	°C	°C	°C	°C	%	°C	°C	-
50	51,2	51,2	51,20000	1,20000	2,4000	± 1,4453	± 2,5	SI
100	101,0	101,0	101,00000	1,00000	1,0000	± 1,4453	± 2,5	SI
150	150,8	150,8	150,80000	0,80000	0,5333	± 1,4453	± 2,5	SI
200	200,8	200,8	200,80000	0,80000	0,4000	± 1,4453	± 2,5	SI
250	249,9	249,9	249,90000	0,10000	0,0400	± 1,4453	± 2,5	SI

Desvíos e Incertidumbres vs Temperatura

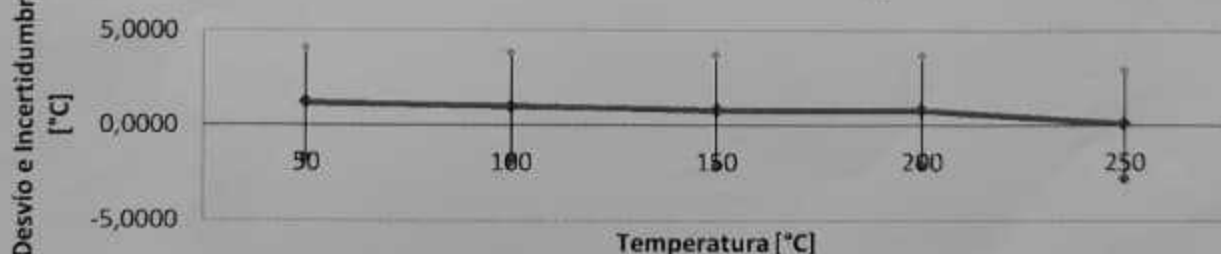

Errores e Incertidumbres vs Temperatura

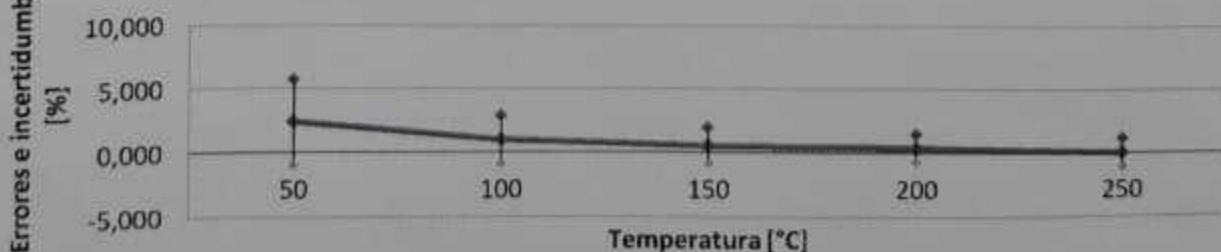


NAVARRETE BIANCA
Técnico Electrónico
Calibrado por:
Bianca A. Navarrete. Técnica de laboratorio


GUILLERMO C. POMPEI
Técnico Electrónico
Mat. TEC 4050
Aprobado por:
Guillermo C. Pompei. Supervisor de laboratorio.