


CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
TCK202012-009



OBJETIVO A CALIBRAR Y/O VERIFICAR

DESCRIPCION DE EQUIPO: PATRON ESCALONADO
MARCA: DMEQ
MODELO: QSR 005
N° DE SERIE: M71117L
IDENTIFICACION: TCK-UT-PAT-001
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: TCK-PPUT-002

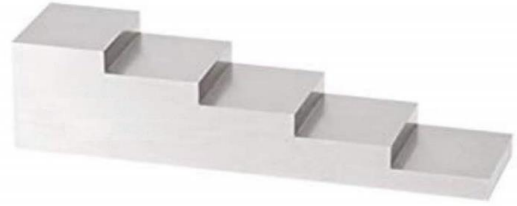

MEDICIONES

Medidas de la Probeta EscalonadaPatron	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm
Mediciones del Operador 1	5,001	10,002	15,004	20,008	25,007
Mediciones del Operador 2	5,001	10,003	15,003	20,005	25,009
VALOR MEDIO	5,001	10,003	15,004	20,007	25,008

Los valores medidos están dentro de las tolerancias requeridas de $\pm 0,10$ mm.

RESULTADOS OBTENIDOS

Apto
☒

No Apto
☐

Fecha de Verificación: 15/12/2020

Fecha de Emisión: 16/12/2020

Nueva Verificación: 16/06/2021

OBSERVACIONES

Se realiza inspección y control de la condición integral de la pieza; y control del espesor de los escalones en 3 puntos, Resultado Satisfactorio. Sin observación ni detalles relevantes en el mismo.
Certificado Anterior TCK202006-004

PATRONES UTILIZADOS

Descripción	N° SERIE	Identificación	Informe	Fecha
MICROMETRO DIGITAL	M211119L	TCK-CD-MIC-001	DMEQ N°51219-823	05/12/2019

FIRMA:

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares

EJECUTANTE DE VERIFICACION: